INAX

排水目皿

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※転居される場合、つぎに入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

各部の名称…… 1
安全のため必ずお守りください…… 1
お手入れ方法…… 2
- 目皿の清掃…… 2
- ヘアーキャッチャーの清掃…… 2
- トラップの清掃…… 2

アフターサービスについて…… 2

各部の名称

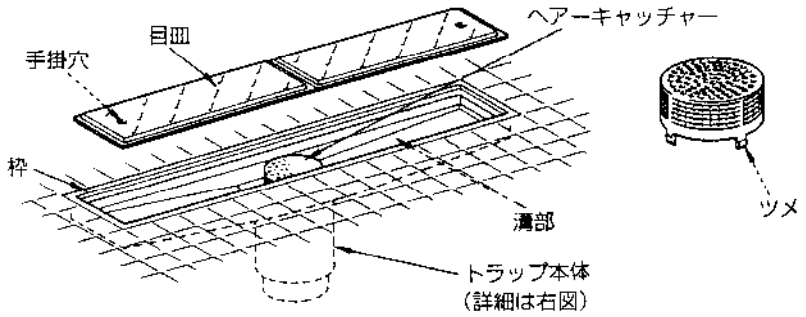

※図はトラップ付排水ユニットで、施工枠付排水目皿についてはトラップおよび溝部がありません。75サイズ以下は目皿は1枚となります。

－トラップ部詳細－

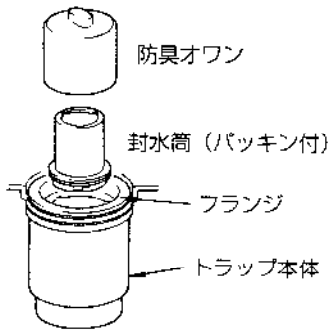

安全のため必ずお守りください

ここではお客様が目皿を安全にご使用していただくために、人身事故や家財の損害を回避するための注意事項を挙げています。
ご使用する前にこの項目をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

用語および記号の説明

⚠ **警告** …… 「取扱いを誤ると、死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** …… 「取扱いを誤ると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ …… 気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

🚫 …… 行ってはいけない「禁止」の内容です。

❗ …… 必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告

目皿が枠よりはみ出した状態（反りなど）では使用しないでください。🚫
※ケガや転倒事故につながる恐れがあります。

⚠ 注意

目皿の手掛穴には強く指を入れないでください。🚫
※指が抜けなくなったりケガをする恐れがあります。
→万一抜けなくなった場合は指に石ケン等を塗ってゆっくり引き抜いてください。

浴室で使用する洗剤、殺虫剤、カビ取剤、その他薬品類は、容器等に記載の注意表示に従って正しく使用してください。❗
※使い方を誤ると**人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因**になることがあります。

目皿を外して清掃する際は、目皿を平らな床面に置いた状態で行ってください。❗
※目皿が浮いた状態で行うと、目皿が変形しケガにつながる恐れがあります。

目皿を外す際は、必ずビニール手袋・ビニール靴を着用してください。❗
※目皿の落下や肌の状態により思わぬケガにつながることがあります。

目皿を表裏反対にして使用しないでください。🚫
※目皿が外れやすくなり危険です。
－参考－
目皿は、中央部が隆起している方が表側です。



お手入れ方法

お手入れの際、次のものは使用しないでください。
- ●酸性、アルカリ性および塩素系の薬品類。(ヘアーキャッチャー除く)
- ●ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール、漂白剤または塩酸などの薬品や油類。
- ●クレンザー、磨き粉およびサンドペーパーなど粒子の粗い研磨材やタワシ。

※光沢を失わせキズをつけたり、トラップの割れ、変色等の原因になります。

目皿の清掃方法

1.目皿の手掛穴に指先を掛け、目皿を持ち上げ外します。
- ・指を強く入れないようにしてください。
  ※指が抜けなくなる恐れがあります。

2.外した目皿を床面に置きスポンジと洗剤で洗浄します。
- ・目皿を浮かせた状態で洗浄しないでください。
  ※目皿が変形することがあります。
- ・目皿表面を床に当てる場合は、タオル等を床に敷いてください。
  ※キズがつくことがあります。

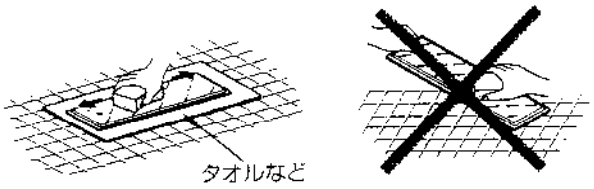

ヘアーキャッチャーの清掃

※トラップ付排水ユニットのみ (1回/週程度)

1.目皿を外します。(左記「目皿の清掃方法」参照)
2.ヘアーキャッチャーの周囲にたまった毛髪等を取り除きます。
3.ヘアーキャッチャーを上方へ引き抜きます。
4.ヘアーキャッチャーに付着した毛髪などを、歯ブラシやシャワーを用いて除去します。
※汚れのひどい時やヌメリのひどい時は、市販のカビ除去剤などを使用してください。
5.ヘアーキャッチャーをもとにもどします。
(ヘアーキャッチャーのツメ部をトラップフランジの切欠部に合わせてはめ込みます)

ー参照ー
トラップの清掃1項「ヘアーキャッチャーの着脱」

トラップの清掃

※トラップ付排水ユニットのみ

以下に示す手順でトラップを分解し清掃してください。

ー注ー ヘアーキャッチャーは、ツメ部を上にして置かないで下さい。踏んでケガをすることがあります。

1.ヘアーキャッチャーの着脱



上方へ引き抜き外します。



ヘアーキャッチャーのツメとフランジの切欠を合わせて押し込みます。

2.防臭オワンの着脱



防臭オワンを反時計方向に回し上へ引き上げます。装着はこの逆の動作になります。

3.封水筒の着脱



封水筒を反時計方向に回し上へ引き上げます。装着はこの逆の動作になります。

アフターサービスについて

不具合を生じたときは

商品に不具合が生じた場合は、お求めの取扱店または、当社支社、お客さま相談室に御相談ください。

《連絡していただきたい内容》
- ●おなまえ・おところ・電話番号
- ●商品名・取付年月日
- ●不具合内容・状況
- ●訪問ご希望日

アフターパーツについて

アフターパーツの御用命は、お求めの取扱店へ御依頼ください。
アフターパーツとしては、以下のものを用意しています。
・ヘアーキャッチャー (品番：PBF-TM2-HC)
販売価格：500円

※補修用部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。

株式会社INAX

本　　社	〒479 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1番地	TEL 0569-35-2700
東京本部	〒160 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号　新宿エルタワー	TEL 03-3343-1700
札幌支社	〒060 札幌市中央区南二条西二丁目18番1　住友生命札幌南二条ビル	TEL 011-271-1701
東北支社	〒980 仙台市青葉区中央4丁目6番1号　住友生命仙台中央ビル	TEL 022-263-1710
東京支社	〒104 東京都中央区八丁堀三丁目10番5号	TEL 03-5541-7111
西東京支社	〒190 東京都立川市錦町3丁目6番6号　中村LKビル	TEL 0425-27-3341
横浜支社	〒231 横浜市中区羽衣町3-55-1　横浜センチュリービル	TEL 045-242-1710
千葉支社	〒260 千葉市中央区中央3丁目3番1号　フジモト第一生命ビル	TEL 043-227-8171
埼玉支社	〒330 大宮市東大成町1-460	TEL 048-668-1177
東関東支社	〒320 宇都宮市大通り2-3-1　千代田生命宇都宮ビル	TEL 028-637-3379
関越支社	〒370 高崎市宮元町21-5　明治生命高崎ビル	TEL 0273-27-1793
甲信支社	〒390 松本市本庄1丁目13番11号　本庄ビル	TEL 0263-36-2166
名古屋支社	〒460 名古屋市中区錦一丁目16番20号　グリーンビルディング	TEL 052-201-1717
静岡支社	〒420 静岡市追手町2番20号　千代田生命静岡ビル	TEL 054-251-1710
北陸支社	〒920 金沢市香林坊1丁目2番20号　朝日生命金沢第2ビル	TEL 0762-64-1710
大阪支社	〒550 大阪市西区新町一丁目34番15号　大阪グレンチェックビル	TEL 06-539-3500
京滋支社	〒604 京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町435　京都御池第一生命ビル	TEL 075-222-1794
広島支社	〒730 広島市中区八丁堀5番17号　住友生命広島八丁堀ビル	TEL 082-223-1710
四国支社	〒760 高松市寿町2丁目2番10号　住友生命高松寿町ビル	TEL 0878-21-1701
福岡支社	〒812 福岡市博多区住吉1丁目2番25号　キャナルシティビジネスセンタービル	TEL 092-282-3151
南九州支社	〒860 熊本市花畑町1-7　安田生命熊本第三ビル	TEL 096-322-1794

■お客さま相談室

東京お客さま相談室— 03-5381-1799　　名古屋お客さま相談室 — 052-201-1733
大阪お客さま相談室— 06-539-3504

取扱店（店名・住所・TEL）

取付日

年　　月　　日

GPB-0025(96080)